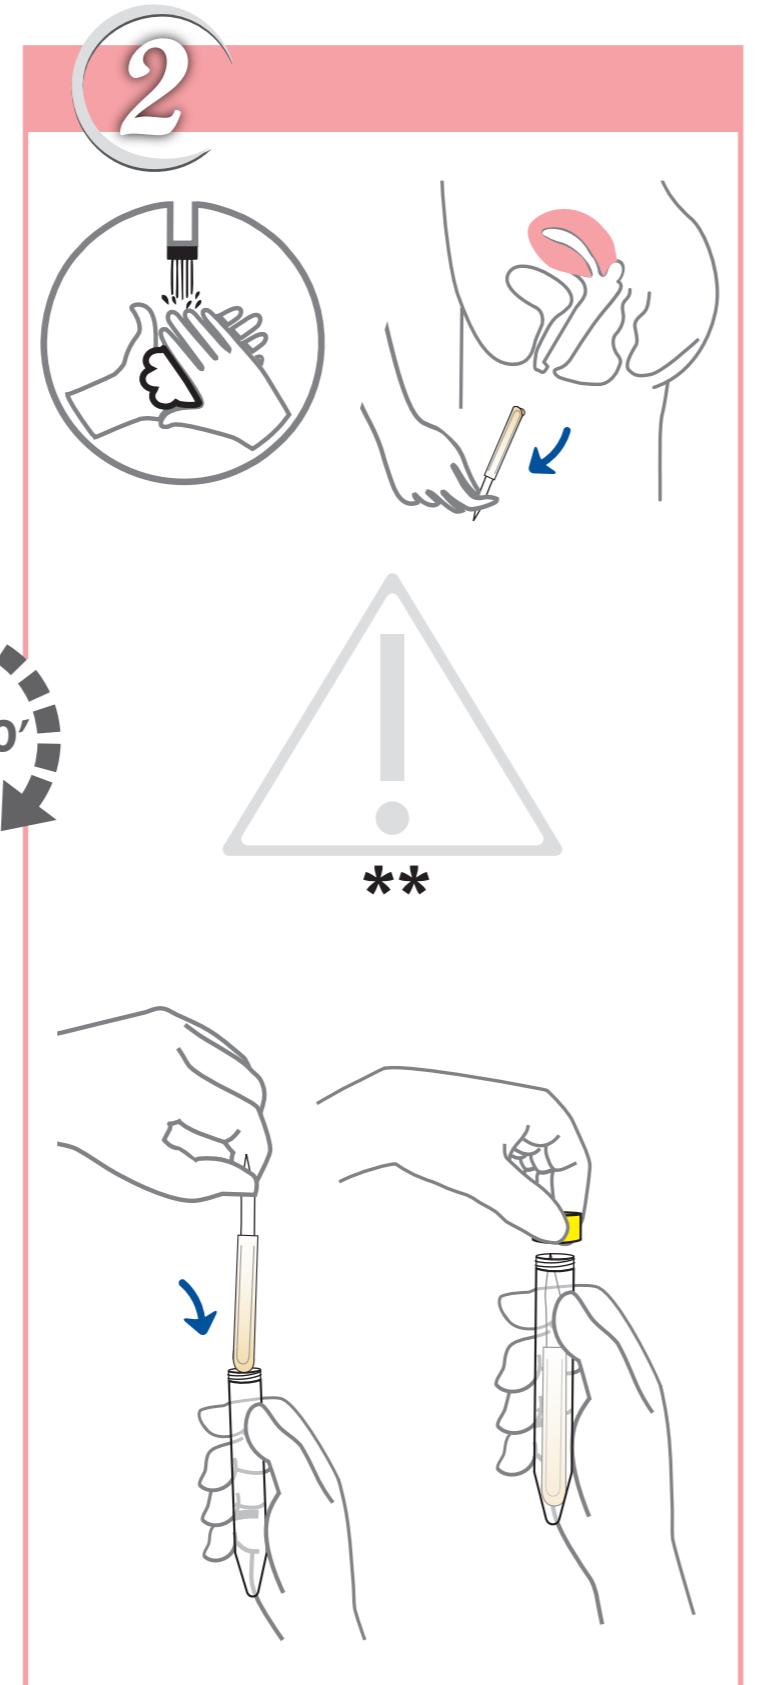
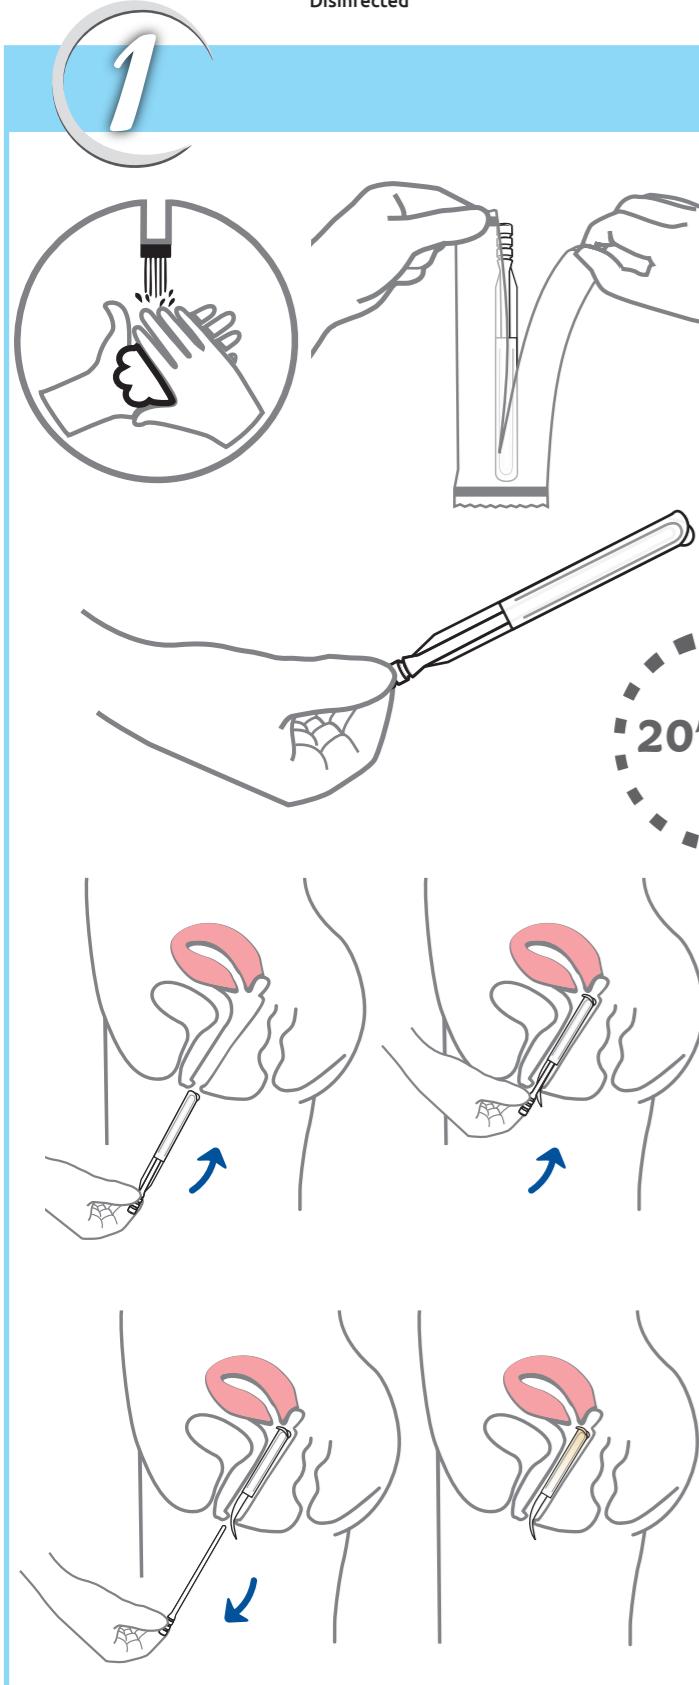
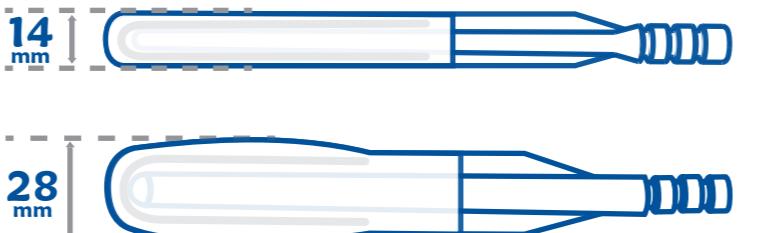


V-Veil UP²™

14/28 mm Veil ; Voile ; Voal ; Schleier ; Velo ; Velo ; حجاب ١٤/٢٨ ; TüL

EN
FR
RO
DE
ES
IT
AR
TK

- UV-C Disinfected
- UV-C Désinfecté
- UV-C Dezinfizat
- UV-C-desinfiziert
- Desinfectado por UV-C
- Disinfettato con UV-C
- تم تطهيره بـ UV-C
- UV-C ile dezenfekte edilmiş

**

The storage container is not included. Use the storage container recommended by your physician or pharmacist.

Le tube de prélèvement n'est pas inclus. Utilisez le tube de prélèvement recommandé par le médecin ou le pharmacien.

Recipientul pentru depozitare nu este inclus. Folosiți recipientul recomandat de doctorul sau farmacistul dumneavoastră.

Das Abstrichröhrchen ist nicht enthalten. Verwenden Sie das von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

El tubo de ensayo no está incluido. Utilizar el tubo de ensayo recomendado por su médico o farmacéutico.

Il tubo di prelevamento non è incluso. Utilizzare il tubo di prelevamento consigliato dal proprio medico o farmacista.

حاوية التخزين ليست مدرجة. قم باستخدام الحاوية التي أوصي بها الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

Saklama kabı dahil değildir. Doktorunuz veya eczacınız tarafından önerilen saklama kabını kullanın.

Authorized distributor: see packaging information.
Patents pending

Distributeur agréé: voir les informations sur l'emballage.
Brevets en cours

Distribuidor autorizado: vedete informațiile inscrise pe ambalaj.
Brevete în aşteptare

Autorisierte Vertriebshändler: siehe
Verpackungsinformationen.
Angemeldete Patente

Distribuidor autorizado: véase la información del envase.
Patentes en trámite

Distributore autorizzato: vedi le informazioni sulla confezione.
Brevetti in corso

الموزع المعتمد: انظر على المعلومات الموجودة على العبوة.
جارى الحصول على براءات الاختراع

Yetkili distribütör: ambalaj bilgilerine bakın.
Patent başvurusu yapılmıştır.

V-VEIL-UP PRODUCTION SRL
Str. Prof. Ion Angelescu, nr 24A, Pitesti, Arges
ROMANIA
client@vvup.org
TEL : 0040 738 886 499

EN Vaginal Veil Collector V-Veil UP² Instructions

Please read and keep this leaflet

WHAT IT IS AND WHEN CAN "V-Veil UP²" BE USED?
Vaginal Veil Collector "V-Veil UP²" is a class I, non-sterile, UVC disinfected medical device for human use used to collect secretions, various fluids and substances, which are in the vaginal cavity and cervix for the diagnosis by laboratory tests. This device may be used during bleeding or pregnancy only at the recommendation of a medical professional. "V-Veil UP²" consists of veil and applicator.

HOW TO USE "V-Veil UP²"?

Wash your hands and dry them with a clean piece of cloth. Open "V-Veil UP²" pack through the intended easy opening area. Discard the used pouch with your normal household waste. Place your fingers at the end of the applicator, the grip area.

Relax and choose the position which is the most comfortable for you, sitting with the legs spread, standing with one leg raised or standing with the legs slightly flexed. Spread the labia located at the opening of the vagina. Gently insert "V-Veil UP²" veil with its applicator. Keep on pushing the veil and the applicator to the grip area. The "V"- shaped terminal part should hang freely on the outside of the vagina. After inserting the Veil, remove its applicator from the vagina. To remove the applicator, gently pull it out, taking care not to pull the veil, also. Discard the applicator with your normal household waste.

ATTENTION: Depending on the size of the vagina and the way you have inserted the "V-Veil UP²" intra-vaginal veil, it is mandatory that the "V"-shaped terminal part remains visible so that it can be removed after use.

HOW TO WITHDRAW "V-Veil UP²"?

Wash your hands and dry them with a clean piece of cloth. Relax and choose the position that suits you (sitting with legs apart, standing with one leg or standing with legs bent). The veil is easily removed by pulling on "V"-shaped terminal part. After removal, place the impregnated veil in a storage container recommended by your physician or pharmacist.

RECOMMENDATIONS AND ADVICES:

- Wash your hands properly before using this medical device.
- Do not use if you have had sexual activities more recently than 2 days.
- Do not use if you have washed the vaginal cavity more recently than 48 hours.
- If you are pregnant or you have blood in the vaginal cavity use this medical device only at the recommendation of your doctor.
- The veil cannot and must not remain in the vagina for more than 30 minutes, but if you forget to remove it, remove it as soon as you remember.
- Use only one "V-Veil UP²" at a time.
- Do not reuse "V-Veil UP²", even if it is not impregnated with bodily fluids.
- The storage container is not included. Use the storage container recommended by your physician or pharmacist.
- For more recommendations ask your doctor or your gynecologist or your chemist.

TO WHOM IS THIS PRODUCT STRICTLY PROHIBITED?

To women who:

- have fever or flu-like symptoms, even if these are mild.
- have already suffered from the toxic shock symptom.
- have an allergy to plastics and derivatives.
- are under 15 years, without their parents and/or medical staff's consent.
- have not read the instructions.

THE TESTS PERFORMED ON "V-Veil UP²:

- Cytotoxicity
- Sensitisation
- Vaginal irritation (over 5 consecutive days)
- The absorption capacity of the veil (1.4 g)

RAW MATERIAL:

- The veil : Non-woven 100% Polyethylene/polyester-bico
- The applicator : 100% Polypropylene-Homopolymer For Medical & Pharmaceutical use by injection molding

IMPORTANT INFORMATION ON THE TOXIC SHOCK SYNDROME:

The Toxic Shock Syndrome (TSS) is a rare but potentially highly dangerous infection. It can occur in children, men and women (having their periods or not). It is caused by toxin produced by a bacteria (Staphylococcus) commonly found in the human body. Half of the cases of TSS known to date occurred among women and teenagers having their monthly periods. TSS was associated with the use of tampons but it can also occur during the periods when one uses other means of protection (sanitary pads, panty-liners etc.). TSS is an infection which can be fatal, this is why it must be identified very early and quickly cured. TSS symptoms can appear suddenly during the periods or a little time afterwards. They might not all appear simultaneously; sudden fever, vomiting, diarrhoea, sore throat, dizziness, fainting, muscle pain, rash that resembles a sunburn (the skin can peel a few days later). If you show these symptoms, you must withdraw "V-Veil UP²", consult your doctor or the nearest available doctor, indicating that you have your monthly periods. TSS can happen with or without the use of "V-Veil UP²". If you already had a TSS, ask your doctor if you can use "V-Veil UP²". If you use "V-Veil UP²" in an adequate way and respect these recommendations, you decrease the risk to develop a Toxic Shock Syndrom.

STORAGE:

To be stored in clean and dry place, away from heat.

REPORTING OF INCIDENTS DUE TO THE MEDICAL DEVICE

Please note, only the leaflet is a reference for legal information as well as its indications and restrictions. Do not use the product if the "V-Veil UP²" packaging is damaged and if the expiration date is exceeded. If, despite all the care we take in the manufacture of our products, you believe that you have a defective product, please do not use it and contact the consumer service or the distributor, indicating precisely the problem you have encountered as well as the lot number specified on the packaging. Incidents related to the device can be reported to the manufacturer at client@vvup.org and to the competent authority of the Member State where you are located. The "V-Veil UP²" Class I medical device is manufactured in the EU in accordance with the applicable provisions and requirements of REGULATION (EU) 2017/745 and complies with the requirements of standard EN ISO 13485: 2016.

This prospectus was revised in 2021.08

FR Voile Vaginal Collecteur V-Veil UP²

Instructions

Veuillez lire cette notice et la conserver

QUE C'EST ET QUAND PEUT LE « V-VEIL UP² » ÊTRE UTILISÉ ?

Le voile vaginal collecteur « V-Veil UP² » est un dispositif médical de classe I, non stérile, désinfecté par UVC, à usage humain, utilisé pour recueillir des sécrétions, divers fluides et substances, qui se trouvent dans la cavité vaginale et le col de l'utérus pour le diagnostic par des tests de laboratoire. Ce dispositif ne peut être utilisé en cas de saignement ou de grossesse que sur recommandation d'un professionnel de la santé. « V-Veil UP² » se compose d'un voile et d'un applicateur.

COMMENT UTILISER "V-Veil UP²" ?

Lavez-vous les mains et essuyez-les avec un linge propre. Ouvrez le sachet de "V-Veil UP²" grâce à l'ouverture facile prévue à cet effet. Jetez le sachet avec les déchets ménagers habituels. Placez vos doigts à l'extrémité de l'applicateur, ou zone de préhension. Décontractez-vous et choisissez la position qui vous convient le mieux, assise avec les jambes écartées, debout avec une jambe relevée ou debout avec les jambes légèrement fléchies. Ecartez les lèvres situées à l'ouverture du vagin. Insérez délicatement le voile « V-Veil UP² » avec son applicateur. Continuez à pousser le voile et l'applicateur vers la zone de préhension. La partie terminale en forme de « V » doit pendre librement à l'extérieur du vagin. Après avoir inséré le Voile, retirez son applicateur du vagin. Pour retirer l'applicateur, tirez-le doucement, en veillant à ne pas tirer le voile aussi. Jetez l'applicateur avec vos déchets ménagers.

ATTENTION : Selon la taille du vagin et la façon dont vous avez inseré le voile intra-vaginal « V-Veil UP² », la partie terminale en forme de « V » doit absolument rester visible pour pouvoir être retirée après utilisation.

COMMENT RETIRER "V-Veil UP²" ?

Lavez-vous les mains et essuyez-les avec un linge propre. Décontractez-vous et choisissez la position qui vous convient le mieux (assis avec les jambes écartées, debout avec une jambe relevée ou debout avec les jambes fléchies). Le voile s'enlève facilement en tirant sur l'extrémité en forme de « V ». Une fois retiré, placez le voile imprégné dans un tube de prélèvement tel que recommandé par le médecin ou le pharmacien.

RECOMMANDATIONS ET CONSEILS :

- Lavez-vous les mains correctement avant d'utiliser ce test.
- Ne pas utiliser si vous avez eu de l'activité sexuelle les 2 derniers jours.
- Ne pas utiliser si vous avez lavé la cavité vaginale plus récemment que 48 heures.
- Si vous êtes enceinte ou si vous avez du sang dans la cavité vaginale, utilisez ce test uniquement à la recommandation de votre médecin.
- Le voile ne peut pas et ne doit pas rester dans le vagin pendant plus de 30 minutes, mais si vous oubliez de le retirer, retirez-le dès que vous vous en souvenez.
- Utilisez un seul "V-Veil UP²" à la fois.
- Ne pas réutiliser "V-Veil UP²", même s'il n'est pas imprégné.
- Le tube de prélèvement n'est pas inclus. Utilisez le tube de prélèvement recommandé par le médecin ou le pharmacien.
- Si vous avez besoin de plus de conseils, parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue ou à votre pharmacien.

A QUI CE PRODUIT EST-IL FORMELLEMENT INTERDIT ?

Aux femmes ayant :

- de la fièvre ou des symptômes de type grippal même très léger.
- déjà contracté un syndrome du choc toxique.
- une allergie aux matières plastiques avec ses dérivés.
- moins de 15 ans sans l'accord des parents et/ou du corps médical.
- volontairement pas pris connaissance de la notice d'utilisation incluse dans l'emballage.

LES TESTS PRATIQUÉS SUR "V-Veil UP²":

- La cytotoxicité
- La sensibilisation
- L'irritation vaginale (sur 5 jours en continu)
- La capacité d'absorption du voile (1,4 g)

MATIERE PREMIERE :

- Le voile : 100% polyéthylène/polyester-bico non tissé
- L'applicateur : 100% polypropylène-homopolymère à usage médical et pharmaceutique par moulage par injection

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE SYNDROME DU CHOC TOXIQUE:

Le Syndrome de Choc Toxique (SCT) est une infection rare mais potentiellement très dangereuse. Il peut toucher les enfants, les hommes et les femmes (qu'elles aient leurs règles ou pas). Il est dû à une toxine produite par une bactérie (staphylocoques) présente communément dans votre corps. La moitié des cas de SCT répertoriés à ce jour sont survenus chez des jeunes filles ou des femmes pendant leurs règles. Le syndrome a été associé à l'utilisation des tampons mais il peut également se déclarer lors des règles lorsqu'on utilise d'autres moyens de protection (serviettes, protège-slips...). Le SCT est une infection qui peut être fatale, c'est pourquoi il doit être identifié très tôt et soigné rapidement. Les symptômes du SCT peuvent apparaître soudainement au cours des règles ou peu de temps après. Ils peuvent ne pas être tous présents et ne pas apparaître simultanément : fièvre soudaine, vomissements, diarrhées, maux de gorge, vertiges, évacuations, douleurs musculaires, éruptions cutanées ressemblant à un coup de soleil (la peau peut peler quelques jours plus tard). Si vous présentez ces symptômes, vous devez retirer "V-Veil UP²", consulter immédiatement votre médecin ou le médecin le plus proche et lui préciser si vous avez vos règles. Le SCT peut se produire avec ou sans l'utilisation de "V-Veil UP²". Si vous avez déjà eu un SCT, parlez-en à votre médecin avant de utiliser un "V-Veil UP²". Si vous utilisez "V-Veil UP²" de manière adéquate et respectez les recommandations, vous diminuez le risque de développer un syndrome de choc toxique.

STOCKAGE:
A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur.

DÉCLARATION DES INCIDENTS DUS AU DISPOSITIF MÉDICAL

Attention, seule la notice à valeur de référence pour l'information légale ainsi que ses indications et restrictions. N'utilisez pas le produit si l'emballage «V-Veil UP²» est endommagé et si la date de péremption est dépassée. Si malgré tout le soin que nous apportons à la fabrication de nos produits, vous estimez être en présence d'un produit défectueux, merci de ne pas l'utiliser et de contacter le service consommateur ou le distributeur en indiquant précisément le problème que vous avez rencontré ainsi que le numéro de lot spécifié sur l'emballage. Les incidents liés au dispositif peuvent être signalés au fabricant à l'adresse client@vvup.org et à l'autorité compétente de l'Etat membre où vous vous trouvez. Le dispositif médical de classe I «V-Veil UP²» est fabriqué dans l'UE conformément aux dispositions et exigences applicables de la RÈGLEMENT (UE) 2017/745 et est conforme aux exigences de la norme EN ISO 13485: 2016.

Ce prospectus a été révisé en 2021.08

Ro Voal Vaginal Colector V-Veil UP²[™]

Instrucțiuni

Vă rugăm să citiți și să păstrați acest prospect

CE ESTE SI CÂND POATE FI UTILIZAT "V-Veil UP²"?

Voalul vaginal colector "V-Veil UP²" este un dispozitiv medical de clasa I, nesteril, desinfecțat UVC, pentru uz uman, utilizat pentru colectarea secretei, diferențelor lichide și substanțe, care se află în cavitatea vaginală și pe colul uterin în vederea diagnosticării prin analize de laborator. Acest dispozitiv poate fi utilizat în timpul sănătăților sau al sarcinii doar la recomandarea unui specialist în domeniul medical. "V-Veil UP²" se compune din voal și aplicator.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A "V-Veil UP²"

Spălați-vă pe mâini și stergăți-le cu un prosop curat. Deschideți pachetul "V-Veil UP²" în partea specială prevăzută în acest sens. Aruncați pachetul împreună cu deșeurile menajere obisnuite. Prindeți cu degetele aplicatorul de partea terminală (în zona de prindere). Relaxați-vă și alegeți poziția care vă se pare cea mai confortabilă, săzând cu picioarele depărtate, în picioare cu un picior ridicat sau în picioare cu picioarele ușor flexate. Depărtați labii exterioare și apropiți partea superioară a "V-Veil UP²" de vagin. Introduceți usor voalul "V-Veil UP²" cu ajutorul aplicatorului. Continuați să impingeți usor voalul și aplicatorul până la zona de prindere. Partea terminală în formă de "V" trebuie să atârnă liber în exteriorul vaginului. După introducerea voalului întăriți aplicatorul acestuia din vagin. Pentru a scoate aplicatorul, trageți-l usor afară, având grijă să nu trageți și voalul. Aruncați aplicatorul împreună cu deșeurile menajere obisnuite.

ATENȚIE: În funcție de dimensiunea vaginului și de modul în care ai introdus voalul intra-vaginal, "V-Veil UP²", este obligatoriu ca extremitatea în formă de "V" să rămână vizibilă, astfel încât să poată fi îndepărtat după utilizare.

PENTRU A SCOATE "V-Veil UP²:

Spălați-vă pe mâini și stergăți-le cu un prosop curat. Relaxați-vă și alegeți poziția care vă se pare cea mai confortabilă (săzând cu picioarele depărtate, în picioare cu un picior ridicat sau în picioare cu picioarele flexate). Voalul se îndepărtează ușor trăgând de partea terminală în formă de "V". După îndepărțare, introduceți voalul împregnat într-un recipient pentru depozitare recomandat de medicul sau farmacistul dumneavoastră.

RECOMANDĂRI SI SFATURI:

- Spălați-vă pe mâini corect înainte de a utiliza acest dispozitiv medical.
- Nu utilizați dacă atât auvitate activitate sexuală în ultimele 2 zile.
- Nu utilizați dacă și spălat înainte de a utiliza.
- Dacă sunteți însărcinată sau prezentăți sânge în cavitatea vaginală, utilizați acest dispozitiv medical numai la recomandarea medicului dumneavoastră.
- Voalul nu poate și nu trebuie să rămână în vagin mai mult de 30 de minute, însă dacă uitați să înlăturați, îndepărtați-l imediat ce v-ați amintit.
- Utilizați un singur "V-Veil UP²" odată.
- "V-Veil UP²" nu trebuie refolosit, nici măcar atunci când nu este împregnat.
- Recipientul pentru depozitare nu este inclus. Folosiți recipientul recomandat de doctorul sau farmacistul dumneavoastră.
- Pentru mai multe recomandări, discutați cu medicul, ginecologul sau farmacistul dumneavoastră.

CUI Î ESTE INTERZISĂ FOLOSIREA ACESTUI PRODUS?

Femeilor care:

- au febră sau simptome de tip gripă, chiar și în formă ușoară.
- au contractat deja un sindrom de șoc toxic.
- sunt alergice la materialele plastice și derivate ale acestora.
- au sub 15 ani, fără acordul părinților și/sau al unui cadru medical.
- nu au cîtuit în mod deliberat fișa de instrucțiuni.

TESTELE EFECTUATE CU PRIVIRE LA "V-Veil UP²:

- Citotoxicitate
- Sensibilitate
- Iritație vaginală (temp de 5 zile consecutiv)
- Capacitatea de absorbție a voalului (1,4 g)

MATERIE PRIMĂ:

- Voalul: 100% Polietilenă/Poliester-bico
- Aplicatorul: 100% Polipropilenă-Homopolimer pentru uz Medical & Farmaceutic turnată prin injecție

INFORMATII IMPORTANTE PRIVIND SINDROMUL DE SOC TOXIC:

Sindromul de soc toxic (SST) este o infecție rară dar poate fi foarte periculoasă. Poate afecta copiii, bărbatii și femeile (indiferent dacă sunt sau nu în menstruatie). Este cauzat de o toxină produsă de o bacterie (stafilococ) care există în mod obișnuit în corp. Jumătate din cazurile de SST sunt înregistrate până în prezent au apărut la adolescentă și femei în timpul menstruatiei. Sindromul a fost asociat cu utilizarea tamponelor, dar poate apărea de asemenea și când sunt utilizate alte mijloace de protecție (absorbante, linere...). SST este o infecție care poate fi fatală și din acest motiv trebuie depistată foarte devreme și tratată imediat. Simptomele SST pot apărea brusc, în timpul menstruatiei, sau la puțin timp după aceea. Este posibil să nu fie toate prezente și să nu apară simultan: febră bruscă (>39°C), vărsături, diaree, dureri în gât, vertigii, leșin, dureri musculare, erupții cutanate similar arsurilor solare (pielea se poate decoji către zile mai târziu). Dacă prezintă aceste simptome, trebuie să scoatăți imediat "V-Veil UP²", să consultați medicul personal sau medicul cel mai apropiat să-i spună dacă sunteți la menstruatie. SST poate apărea cu sau fără utilizarea "V-Veil UP²". Dacă atât dezvoltăți dejă un SST, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza "V-Veil UP²". Utilizând corect "V-Veil UP²" și respectând recomandările, veți diminua riscul de dezvoltării un sindrom de soc toxic.

PĂSTRARE:

A se păstra într-un loc curat și uscat, departe de surse de căldură.

RAPORTAREA INCIDENTELOR DATORATE DISPOZITIVULUI MEDICAL

Atenție, doar fișa de instrucțiuni poate fi folosită ca referință pentru informații legale, indicații și restricții. Nu utilizați produsul dacă ambalajul "V-Veil UP²" este deteriorat și dacă termenul de valabilitate este depășit. În cazul în care, împofnați măsurilor pe care le luăm în cadrul procesului de fabricație, considerați că atât primul un produs cu defecțiuni, vă rugăm să nu îl utilizați și să lăuați legătură cu producătorul sau distribuitorul, indicând clar problema întâmpinată precum și numărul de lot specificat pe ambalaj. Incidentele legate de dispozitiv pot fi raportate producătorului la adresa de email client@vvup.org și către autoritatea competentă a statului membru în care sunteti localizati. Dispozitivul medical Clasa I "V-Veil UP²" este produs în conformitate cu prevederile și cerințele aplicabile ale REGULAMENTULUI (UE) 2017/745 și respectă cerințele din standarul EN ISO 13485: 2016.

Acest prospect a fost revizuit în 2021.08

DE Schleier-Vaginalsammler V-Veil UP²[™]

Anweisungen

Lesen Sie bitte diese Packungsbeilage und bewahren Sie sie auf

ES Velo vaginal colector V-Veil UP²[™]

Instrucciones

Léase y conserve este prospecto

IT Velo Vaginale Collettore V-Veil UP²[™]

Istruzioni

Si prega di leggere e conservare questo opuscolo

AR V-Veil UP²[™]

جهاز مهني للجمجمة

تغليمات استخدام

يرجى القراءة والاحتفاظ بهذه المنشور

TK Vajinal Tül Toplayıcı V-Veil UP²[™]

Talimatlar

Lütfen talimatları okuyun ve bu broşürü saklayın

يجب الارجاع والاحتفاظ بهذه المنشور

WAS IST „V-Veil UP²“ UND WANN KANN ER VERWENDET WERDEN ?

Der Schleier-Vaginalsammler „V-Veil UP²“ ist eine unsterile, mit UVC desinfizierte medizinische Vorrichtung der Klasse I für den menschlichen Gebrauch, die zur Entnahme von Sekreten, verschiedenen Flüssigkeiten und Substanzen, die sich in der Vaginalhöhle und im Gebärmutterhals befinden, für die Analysen im Laboratorium. Dieser Dispositiv kann während der Menstruation oder Schwangerschaft nur auf Empfehlung medizinischer Fachleute verwendet werden. „V-Veil UP²“ besteht aus Schleier und Applikator.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ VERWENDET ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Öffnen Sie die „V-Veil UP²“ Packung am für das einfache Öffnen vorgesehenen Teil. Entsorgen Sie den gebrauchten Beutel über den normalen Haushaltsmüll. Legen Sie Ihre Finger am Ende des Applikators, im Griffbereich. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die am bequemsten für Sie ist, sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit leicht gebeugten Beinen. Spreizen Sie die äußeren Schamlippen und bringen Sie das Oberteil des „V-Veil UP²“ nah an die Scheide. Führen Sie den „V-Veil UP²“ mit dem Applikator behutsam ein. Schieben Sie leicht den Schleier und den Applikator weiter zum Griffbereich. Das V-förmige Endteil muss frei an der Außenseite der Scheide hängen. Nach Einführung des Schleiers entfernen Sie dessen Applikator aus der Scheide. Um den Applikator zu entfernen, ziehen Sie ihn sanft und achten Sie darauf, dass Sie nicht auch den Schleier ziehen. Entsorgen Sie den Applikator über den normalen Haushaltsmüll.

ACHTUNG: Je nach Größe der Scheide und der Art und Weise, wie Sie die intravaginale Schleier „V-Veil UP²“ eingeführt haben, ist es zwangsläufig erforderlich, dass das V-förmige Endteil sichtbar bleibt, damit es nach Gebrauch entfernt werden kann.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die Ihnen passt (sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit gebeugten Beinen). Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht. Nach Entfernung legen Sie den imprägnierten Schleier in ein von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die Ihnen passt (sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit gebeugten Beinen). Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht. Nach Entfernung legen Sie den imprägnierten Schleier in ein von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die Ihnen passt (sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit gebeugten Beinen). Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht. Nach Entfernung legen Sie den imprägnierten Schleier in ein von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die Ihnen passt (sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit gebeugten Beinen). Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht. Nach Entfernung legen Sie den imprägnierten Schleier in ein von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die Ihnen passt (sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit gebeugten Beinen). Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht. Nach Entfernung legen Sie den imprägnierten Schleier in ein von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die Ihnen passt (sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit gebeugten Beinen). Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht. Nach Entfernung legen Sie den imprägnierten Schleier in ein von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die Ihnen passt (sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit gebeugten Beinen). Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht. Nach Entfernung legen Sie den imprägnierten Schleier in ein von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die Ihnen passt (sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit gebeugten Beinen). Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht. Nach Entfernung legen Sie den imprägnierten Schleier in ein von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die Ihnen passt (sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit gebeugten Beinen). Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht. Nach Entfernung legen Sie den imprägnierten Schleier in ein von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die Ihnen passt (sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit gebeugten Beinen). Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht. Nach Entfernung legen Sie den imprägnierten Schleier in ein von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die Ihnen passt (sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit gebeugten Beinen). Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht. Nach Entfernung legen Sie den imprägnierten Schleier in ein von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die Ihnen passt (sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit gebeugten Beinen). Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht. Nach Entfernung legen Sie den imprägnierten Schleier in ein von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab. Entspannen Sie sich und wählen Sie die Haltung, die Ihnen passt (sitzend mit gespreizten Beinen, stehend mit einem hochgestellten Bein oder stehend mit gebeugten Beinen). Der Schleier kann einfach entfernt werden, indem man am V-förmigen Endteil zieht. Nach Entfernung legen Sie den imprägnierten Schleier in ein von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlene Abstrichröhrchen.

WIE WIRD „V-Veil UP²“ ENTFERNT ?</